


СЕРТИФИКАЦИЯ CE  
ШКАЛА РЕГУЛИРОВКИ 30 оС – 90оС погр. 3оС  
КАЛИБРОВКА В НОРМАЛИЗОВАННОЙ ЕМКОСТИ ПРИ 89 оС +/- 3 оС  
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4оС +/- 2 оС  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА 6,3мм С ЗАЖИМАМИ НА ВИНТАХ  
T80

APPROVALS   

TEMPERATURE RANGE : 30°C–90°C±3°C  
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH : 89°C±3°C  
TABS TYPE 1/4" WITH SCREW TERMINALS  
DIFFERENTIAL : 4°C±2°C  
T80

Цвет корпуса оранжевый  
Цвет ручки черный

COLOURS . BOX : ORANGE  
KNOB : BLACK

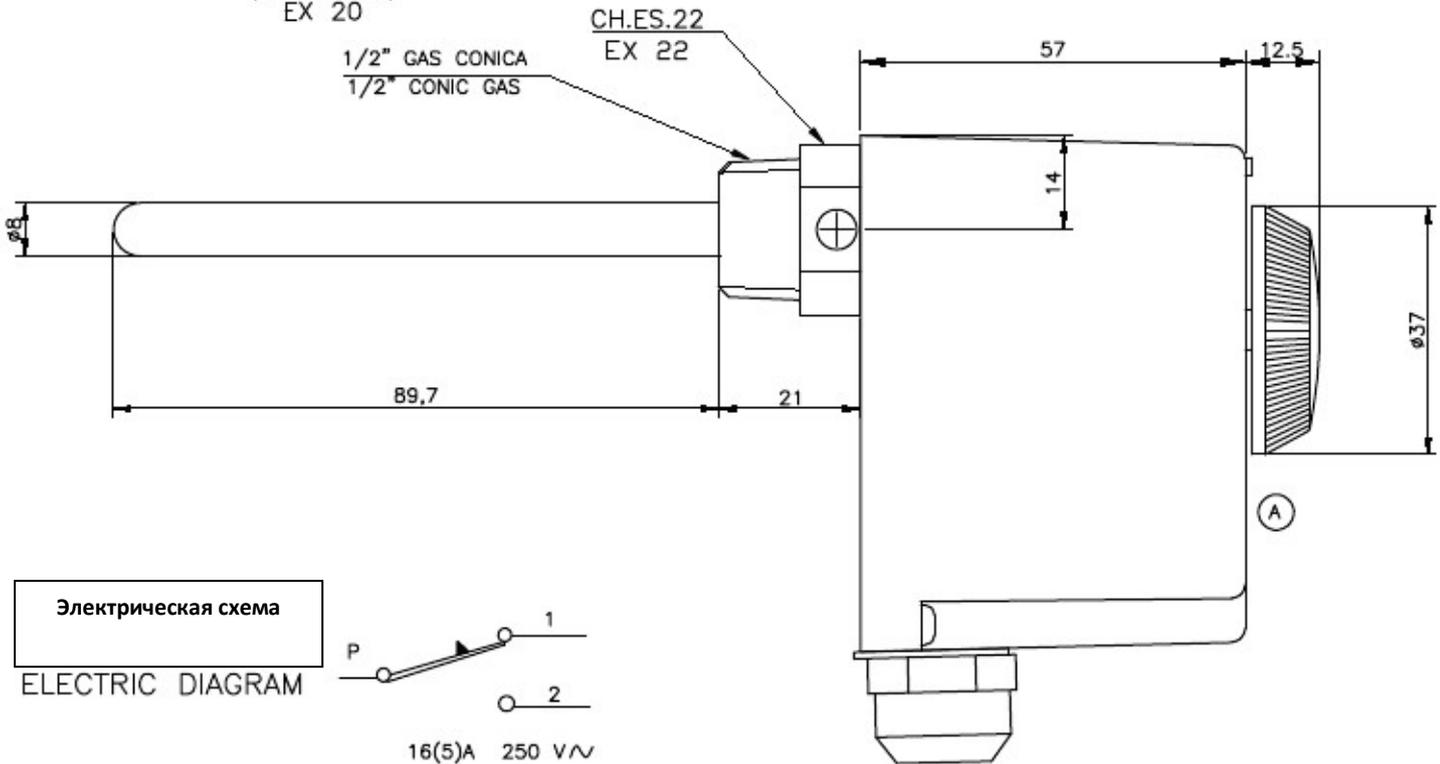

Электрическая схема

ELECTRIC DIAGRAM

